




HIOKI

温度ロガー 3650

データロガー 

超小型・ボタンサイズで温度記録

このサイズで

17.35mm

最大 2048 データの温度記録
(4 時間 15 分間隔で約 1 年間)
-40℃～85℃の広範囲測定
センサ、メモリ、電源内蔵

パソコン用

データリーダー
3920



手軽に解析
記録したデータを専用のデータリーダー
3920 で収集。付属のソフトでグラフ表
示・管理が簡単にできます。

抗菌仕様の専用ホルダーで
どこでも手軽に設置
マグネット・ビス等で簡単に取り付けできます。




ISO 9001
JMI-0216


ISO14001
JQA-E-90091




 www.hioki.co.jp
お問い合わせは... info@hioki.co.jpまで

食品加工・展示・販売・輸送の温度記録に

温度管理システムを革新する超コンパクトロガー

■ 温度データはパソコンで手軽に解析・管理 解析ソフト付属

記録されたデータは、データリーダー 3920 でパソコンに取り込み、簡単にグラフ表示・管理・保存ができ、Max.16ch のグラフ表示ができます。

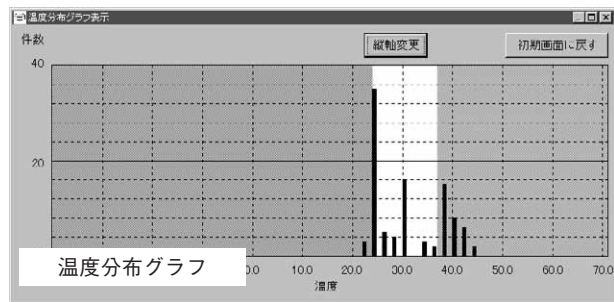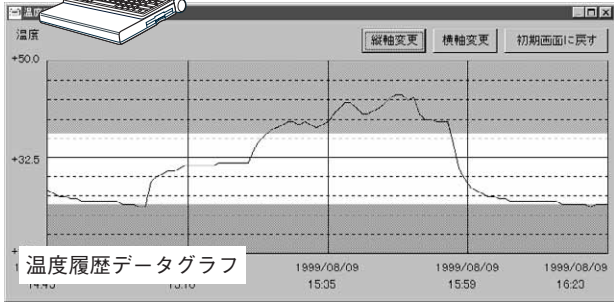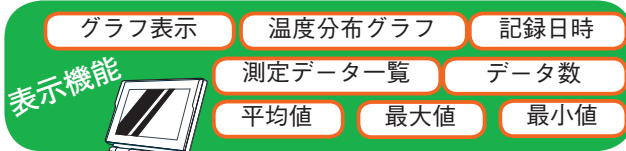

■ 2048 データ・最長約 1 年間の測定温度を記録

最大 2048 データの記録ができます。測定間隔は 1 分～255 分の範囲で設定でき、最長約 1 年間の温度記録ができます。


(電池寿命は、測定間隔 5 分 50℃ 以下で連続使用した場合約 4 年です。電池交換不可。)

測定間隔	記録時間
1 分	1.4 日
3 分	4 日
5 分	7 日
10 分	14 日
30 分	42 日
60 分	85 日
:	:
4 時間 15 分	約 1 年

■ 温度異常も簡単・確実に記録

- 警報発令温度の上・下限が設定でき、温度異常の有無が確認できます。
- 本体にメモ機能を装備しており、測定場所などの情報を書きとめておけます。

設定内容

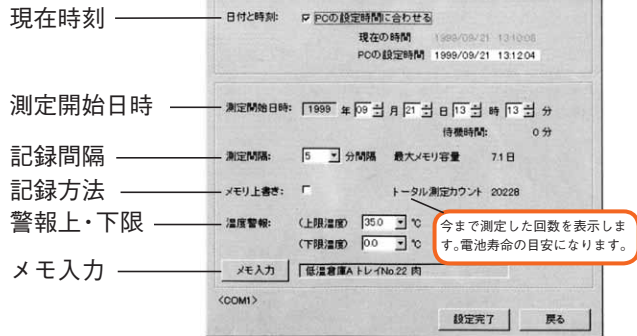

■ 温度ロガー 3650 仕様

測定範囲	温度: -40.0 ~ 85.0℃ (分解能 0.5℃)、1ch 湿度: -40.0 ~ 10.5℃; ±2℃ -10.0 ~ 30.0℃; ±1.5℃ 30.5 ~ 85.0℃; ±2℃
対応記録記録記録記録	容量: 最大 10 分変化量に対して 90% の値を示すまでの時間、参考値) 2,048 データ(255 分間隔記録で約 1 年) 開始: 予約時間スタート 終了: エンドレス/フルメモリ 記録間隔: 1 分 ~ 255 分 記録方法: ワンタイム; メモリフルによりストップ エンドレス; メモリフルにより最古データ上書き
インターフェース	RS-232C (データリーダー 3920 使用)
電池寿命	源: 電池内蔵 (交換不可)、測定回数 50 万回以上 寿命: 約 4 年(50℃ 以下、記録間隔 5 分で連続使用時)
寸法・質量	約直径 17.35 × 厚さ 5.89 mm × 3.3 g
使用・保存温度範囲	-40 ~ 85℃
本体材質	ステンレス; SUS304
防水構造	日常生活防水 ※ 水中に水没させての使用はできません。
付属品	専用取付けホルダー、マグネットシール、ホルダ取付けネジ
オプション	データリーダー 3920
適合規格	EMC EN61326

■ データリーダー 3920 仕様

寸法・質量	約 108.5W × 25.0H × 6.5D mm ・ 約 84g
使用温湿度範囲	0 ~ 40℃、85% rh 以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲	0 ~ 40℃、85% rh 以下 (結露しないこと)
付属品	通信アダプタ、通信ケーブル、PC 用通信ソフト (CD-R × 1 枚)
適合規格	EMC EN61326
動作 OS	Windows 7※(32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000/Me/98/95
プリント	グラフプリント (Max.16ch 分)
ファイル形式	独自形式 (バイナリコード) テキスト変換可 (CSV 形式) CSV 形式: カンマで区切られたテキスト形式。 Excel で直接読み込み可。

● PC 用通信ソフト仕様

※ Windows 7 では以下の制限があります (印刷できないプリンタがあります/グラフ横軸ラベルが文字欠けする場合があります/ヘルプを表示できません)

■ 価格

- 温度ロガー 3650 ¥8,600 (税抜き)
- オプション
データリーダー 3920 ¥29,500 (税抜き)

■ このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ ご購入時に成績表および校正証明書をご希望されるお客様は、別途ご発注をお願いいたします。

HIOKI

日置電機株式会社

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559
〒386-1192 長野県上田市小泉 81
東北(営) TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1
長野(営) TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569
〒386-1192 長野県上田市小泉 81
東京(営) TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3

北関東(営) TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842
〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24
横浜(営) TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-13-6
名古屋(営) TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083
〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F
大阪(営) TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26
広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253
〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13
福岡(営) TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275
〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

お問い合わせは...